2017/3/6
株式会社　大王製作所

定 量 分 析 結 果 報 告 書

[試料情報]

端末名	EA1000AIII
測定日時	2017/3/6 12:41
製品名	カラビナフック
品番	カラビナフック
測定部位	本体
ロットNo.	
備考	
オペレータ	Staff

[試料画像]

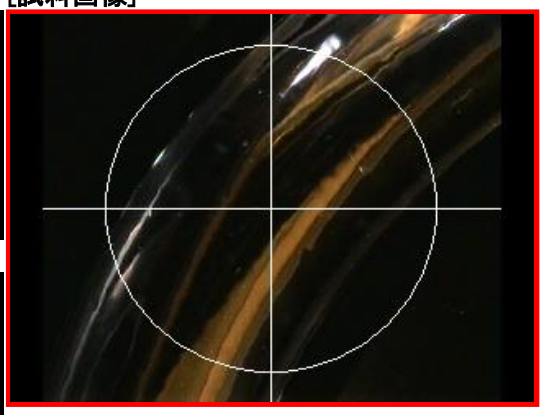

[測定条件]

レシピ	002 HSM1000A3(金属)			
	条件1	条件2	条件3	条件4
測定時間 (秒)	40	81	101	
デッドタイム (%)	34	9	33	
管電圧 (kV)	40	50	15	
管電流 (uA)	161	1000	303	
フィルター	Pb用	Cd用	Cr用	
雰囲気	大気	大気	大気	
機種名	EA1000AIII ID0100 (11.03.1.0)			
コリメータ	φ5.0mm			
測定法	バルクFP C:¥XRAY¥ANA¥HSM1000A3.bfp			
備考	PeakingTime=6.4usec / マイラー=NONE			

[分析結果]

総合判定	○	変更コメント	
N sigma	3		

		濃度 (ppm)	濃度判定	統計誤差 3σ(ppm)	統計誤差 判定	X線強度 (cps)	強度誤差 3σ(cps)	変更コメント
Cd	Ka	3	○	29	○	0.1	0.7	
Pb	La	0	○	179	○	0.0	1.4	
Hg	Lb	0	○	192	○	0.0	1.5	
Br	Ka	0	—	67	○	0.0	1.6	
Cr	Ka	0	○	197	○	0.0	3.5	
包装材								
Cd+Pb+Hg+Cr		3		–	–	–	–	

主要元素	Cu	Ni	Sn	Ba			
濃度 (wt%)	78.4	21.54	0.06	0			
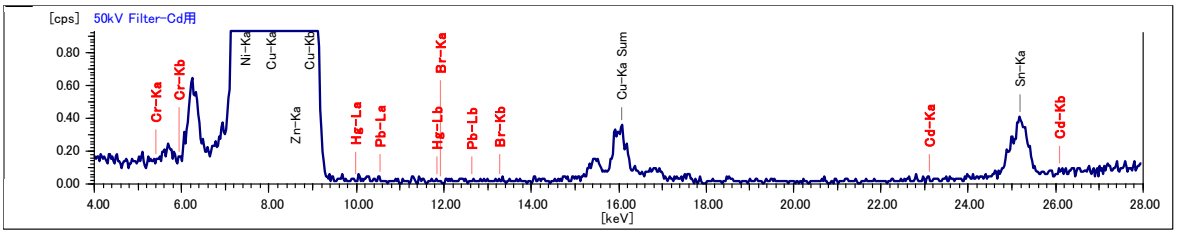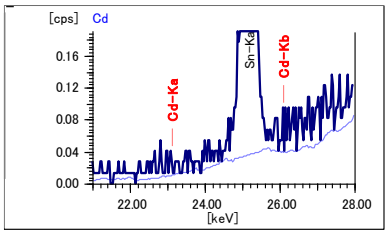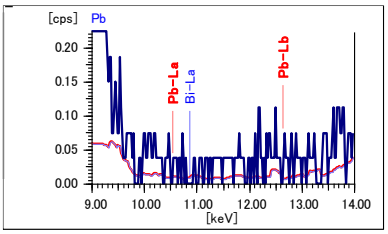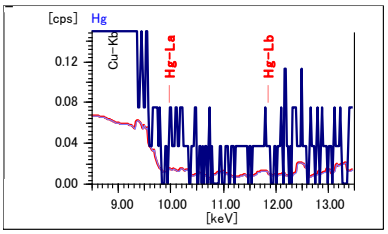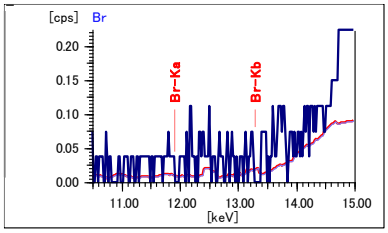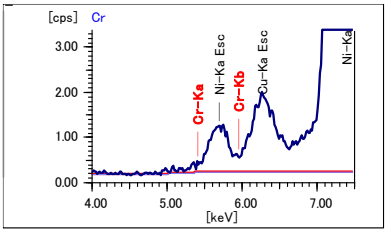
[スペクトル]